


İL AMBULAN SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
TIBBİ SARF TEKNİK SARTNAMESİ 2016

1.ASPİRASYON SONDASI NO:16

1. Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı, aspirasyon sırasında kanamaya neden olmamalıdır.
3. Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalıdır.
4. Sondalar nontoksik, ajirojen ve antialerjik özellikte olmalıdır.
5. Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Sondalar ihalede istenen ölçülerde olmalıdır.
7. Sondanın uzunluğu 6, 8, 10, 12 Fr numarada konnektörden itibaren 40 (+/-1) cm olmalıdır.
8. Sondanın uzunluğu 14, 16 Fr numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalıdır.
9. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
10. Konnektördişi olmalıdır.
11. Aspirasyon sonda ucu çam ağacına, aspiratör hortum ucuna uyumlu olmalıdır.
12. Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı, ambalajların üzerinde malzeme tanımı yazmalıdır.
13. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
14. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile deęişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
15. Ürünler 100, 200 veya 300'lü kolilerde olmalı ve koliler üzerinde firma bilgileri bulunmalıdır.
16. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhüname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
17. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
18. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
19. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
20. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından

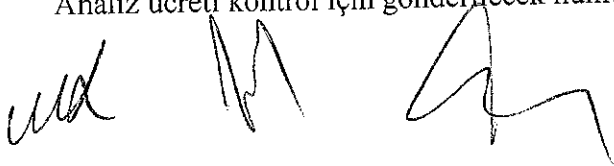


karşılacaktır.

21. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
22. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

2.ASPİRASYON SONDASI NO:18


1. Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı, aspirasyon sırasında kanamaya neden olmamalıdır.
3. Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalıdır.
4. Sondalar nontoksik, apirojen ve antialerjik özellikte olmalıdır.
5. Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Sondalar ihalede istenen ölçülerde olmalıdır.
7. Sondanın uzunluğu 6, 8, 10, 12 Fr numarada konnektörden itibaren 40 (+/-1) cm olmalıdır.
8. Sondanın uzunluğu 14, 16 Fr numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalıdır.
9. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
10. Konnektördişi olmalıdır.
11. Aspirasyon sonda ucu çam ağacına, aspiratör hortum ucuna uyumlu olmalıdır.
12. Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı, ambalajların üzerinde malzeme tanımı yazmalıdır.
13. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
14. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile birebir değişimi(15 gün içinde) sağlanacaktır.
15. Ürünler 100, 200 veya 300'lü kolilerde olmalı ve koliler üzerinde firma bilgileri bulunmalıdır.
16. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
17. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.

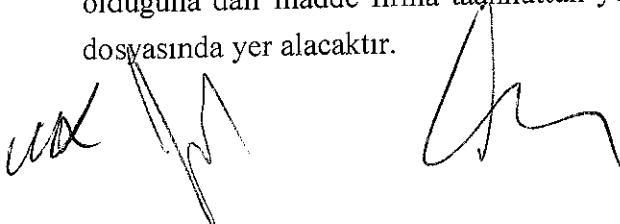

18. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
19. .
20. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
21. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdir de bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
22. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
23. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

3.ASPİRASYON SONDASI NO:10


1. Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı, aspirasyon sırasında kanamaya neden olmamalıdır.
3. Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalıdır.
4. Sondalar nontoksik, ajirojen ve antiallerjik özellikte olmalıdır.
5. Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Sondalar ihalede istenen ölçülerde olmalıdır.
7. Sondanın uzunluğu 6, 8, 10, 12 Fr numarada konnektörden itibaren 40 (+/-1) cm olmalıdır.
8. Sondanın uzunluğu 14, 16 Fr numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalıdır.
9. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
10. Konnektör dişi olmalıdır.
11. Aspirasyon sonda ucu çam ağacına, aspiratör hortum ucuna uyumlu olmalıdır.
12. Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı, ambalajların üzerinde malzeme tanımı yazmalıdır.
13. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
14. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile birebir değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.

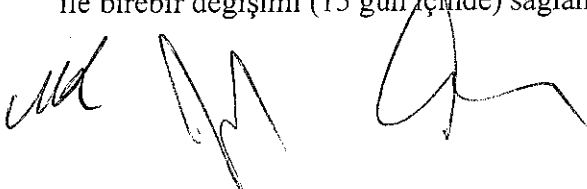

15. Ürünler 100, 200 veya 300'lü kolilerde olmalı ve koliler üzerinde firma bilgileri bulunmalıdır.
16. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
17. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
18. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
19. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
20. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
21. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
22. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

4. İNTRAKET NO:24 (SARI)


1. Kataterin sıyrılmaları önleyecek şekilde özel kesim olmalıdır.
2. Katater materyali PTFE teflon olmalıdır.
3. İğne kesimi back-cut (uç kesimli) olmalıdır.
4. Fleksible tespit edici (Fiksasyon) kanatlı olmalıdır.
5. Ambalaj plastik blister, kapağı yırtılmaz özellikte olmalıdır.
6. Üstten giriş valfi (portu) olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
8. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile birebir değişimi(15 gün içinde) sağlanacaktır
9. Ambalaj üstünde üretici firma adı, imalat tarihi, kullanım süresi, sterilizasyon şekli yazılı olmalıdır.

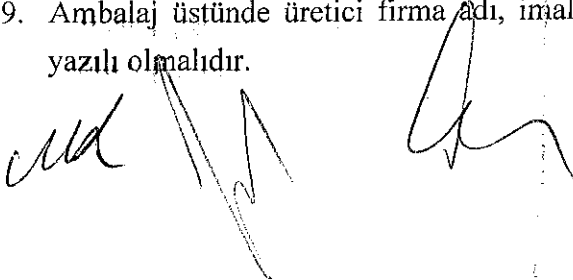

10. Giriş sırasında tutmak için seyyar tutma aparatı olmalıdır.
11. Kataterin içindeki iğne geri çekildiğinde kan görünecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. 50 veya 100'lük kutularda olmalıdır.
13. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
14. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
15. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
16. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
17. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
18. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
19. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

5.TURNİKE

1. Elastik özellikteki **otomatik turnike** kan alma ve damar yolu açma işleminde damarın rahatlıkla bulunmasını sağlamalıdır.
2. Pratik bir şekilde uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.
3. Sıkı bir dokumaya sahip olmalı ve çekerek sıkıştırılabilmelidir.
4. Boyuna esnek plastik bir kilit bulundurur. Otomatik turnike kol ve bacak yaralanmalarında kanamanın durdurulması amacıyla da kullanılabilir olmalıdır.
5. Mandallı ve stoplu olan *otomatik turnike* 40 cm(\pm 2) uzunlukta ve 2,5 cm genişlikte olup standart ebatlıdır.
6. Ürün tekli şekilde paketlenmiş olmalı ve koli içinde teslim edilmelidir.
7. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları

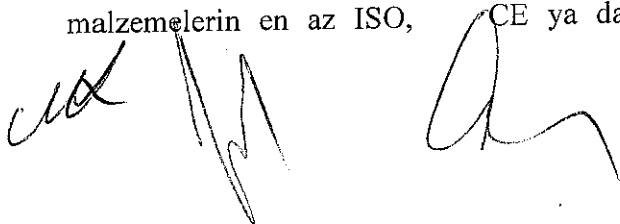


gerekmektedir.

8. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
9. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
10. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
11. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim yapılacaktır.
12. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

6.SARGI BEZİ RULO

1. %100 pamuk ipliğinden olmalıdır.
2. Hidrofil, beyaz, temiz, kokusuz olmalıdır.
3. 10 cm eninde 4 m boyunda olmalıdır.
4. Kendinden kenarlı olmalıdır.
5. Kolay kesilebilmeli ya da elle koparılabilmeli ve elle koparıldıktan sonra koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.
6. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.,
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
8. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile birebir değişimi sağlanacaktır
9. Koruyucu kılıf içinde paketli olmalıdır.
10. Hiçbir boya maddesi içermemelidir.
11. İplik sayısı enine 1cm² sinde 20 tel olmalıdır.
12. 1 m² sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır.
13. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. ÜBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve

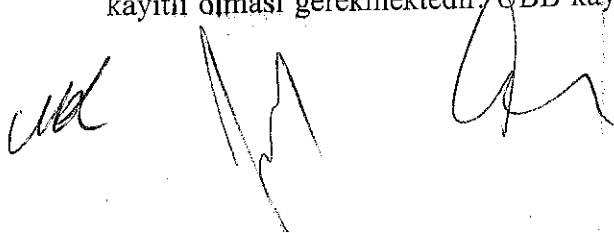


malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.

14. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
15. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
16. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
17. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
18. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
19. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

7.PAMUK


1. 1 kg lık rulolar halinde naylon ambalajda olmalı ve kolilerde teslim edilecektir.
2. % 100 saf pamuk olmalı
3. Dışarıdan malzemenin içeriği görülebilecek nitelikte olmalıdır,
4. Birim ambalaj üzerinde kalite güvence damgası olmalıdır,
5. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
6. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile birebir değişimi sağlanacaktır
7. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
8. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.

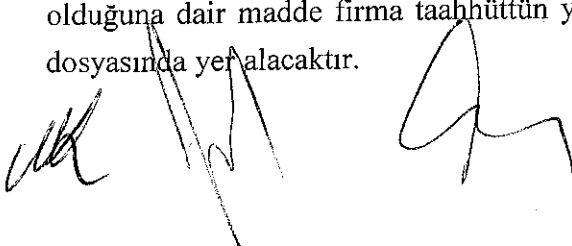

9. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
10. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
11. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
12. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
13. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

8.LARENGEAL MASKE NO:3.0 (TEK KULLANIMLIK)

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir
2. Medikal silikondan veya PVC ' den üretilmiş, vücut sıcaklığında yumuşayabilmelidir. Latex içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril paketlerde teslim edilmelidir.
4. Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüplerden biri havayolunu açık tutmaya yarar iken, diğeri gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır.
5. Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olmalıdır. Burada en çok 16mm.liknazogastrik sonda geçişi sağlanmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm.lik standart konektörü bulunmalıdır.
7. Ürün hasta anatomisine uygun açıda imal edilmiş olmalı, baş boyun manipülasyonuna gerek kalmadan tek elle yerleştirilebilmelidir
8. Maske 3 numara olmalı, 30 kg'dan erişkin hastalara kadar uygulanabilmeli ve kaf şişirme basıncı (kaf hacmi) maksimum 20 ml hava olmalıdır.
9. UBB Kaydı olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar teknik şartnamenin tüm maddelerine uyduklarını madde madde yazılı olarak beyan edeceklerdir.
11. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.Son kullanma

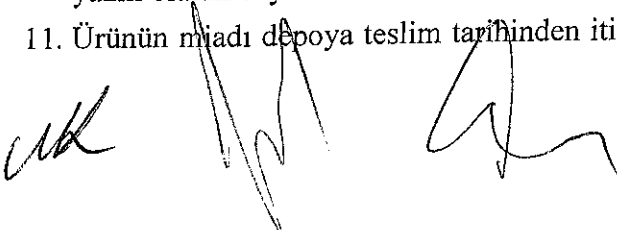


tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.

12. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
13. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
14. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
15. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
16. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
17. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
18. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

9.LARENGEAL MASKE NO:4.0 (TEK KULLANIMLIK)


1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir
2. Medikal silikondan veya PVC ' den üretilmiş, vücut sıcaklığında yumuşayabilmelidir. Latex içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril paketlerde teslim edilmelidir.
4. Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüplerden biri havayolunu açık tutmaya yarar iken, diğeri gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır.
5. Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olmalıdır. Burada en çok 16mm.lik nazogastrik sonda geçişi sağlanmalıdır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm.lik standart konektörü bulunmalıdır.

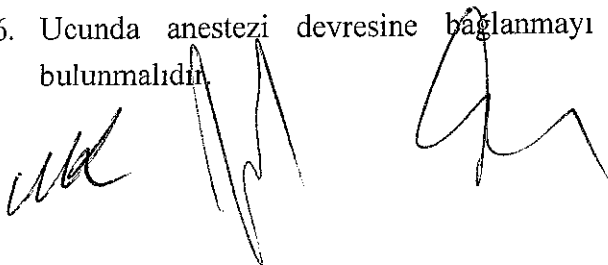

7. Ürün hasta anatomisine uygun açıda imal edilmiş olmalı, baş boyun manüplasyonuna gerek kalmadan tek elle yerleştirilebilmelidir
8. Maske 4 numara olmalı, 50 kg.'dan 70 kg.'a kadar hastalara uygulanabilmeli ve kaf şişirme basıncı (kaf hacmi) maksimum 30 ml hava olmalıdır.
9. UBB Kaydı olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar teknik şartnamenin tüm maddelerine uyduklarını madde madde yazılı olarak beyan edeceklerdir.
11. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
12. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
13. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
14. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
15. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
16. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
17. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
18. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

10. FOLEY KATETER NO:16


1. Sonda silikondan imal edilmiş olmalı.
2. Sonda iki yollu olmalı, balonu şişirildiğinde simetrik olarak kendiliğinden şekillenmelidir.
3. Sonda tekli paketlerde en fazla çift katlanmış olarak steril ambalajlarda olmalı ve sterilizasyon bilgileri paketin üzerinde belirtilmelidir.

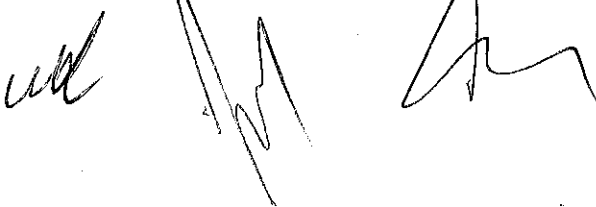

4. Sondanın dışarıda kalan ucuna sondaya uygun torba kolay takılabilmeli ve sızdırmamalıdır.
5. Her bir sondayla birlikte en az bir adet torba verilmeli ve torbanın alt kısmında içindeki sıvıyı boşaltabilecek ve tekrar kullanımına engel olmayacak sızdırmayan kapaklı veya yivli bir düzenek olmalıdır. Milimetre ölçekli olmalı. Borusu dolanmayı engellemelidir
6. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
7. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhütünü yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
8. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az dört yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi(15 gün içinde) sağlanacaktır.
9. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
10. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
11. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
12. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
13. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

11. FOLEY KATETER NO:18

1. Sonda silikondan imal edilmiş olmalı.
2. Sonda iki yönlü olmalı, balonu şişirildiğinde simetrik olarak kendiliğinden şekillenmelidir.
3. Sonda tekli paketlerde en fazla çift katlanmış olarak steril ambalajlarda olmalı ve



sterilizasyon bilgileri paketin üzerinde belirtilmelidir.

4. Sondanın dışarıda kalan ucuna sondaya uygun torba kolay takılabilmeli ve sızdırmamalıdır.
5. Her bir sondayla birlikte en az bir adet torba verilmeli ve torbanın alt kısmında içindeki sıvıyı boşaltabilecek ve tekrar kullanımına engel olmayacak sızdırmayan kapaklı veya yivli bir düzenek olmalıdır. Milimetre ölçekli olmalı. Borusu dolanmayı engellemelidir
6. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
7. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
8. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az dört yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
9. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
10. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
11. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
12. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
13. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

12.FOLEY KATETER NO:20

1. Sonda silikondan imal edilmiş olmalı.
2. Sonda iki yollu olmalı, balonu şişirildiğinde simetrik olarak kendiliğinden

şekillenmelidir.

3. Sonda tekli paketlerde en fazla çift katlanmış olarak steril ambalajlarda olmalı ve sterilizasyon bilgileri paketin üzerinde belirtilmelidir.
4. Sondanın dışarıda kalan ucuna sondaya uygun torba kolay takılabilmeli ve sızdırmamalıdır.
5. Her bir sondayla birlikte en az bir adet torba verilmeli ve torbanın alt kısmında içindeki sıvıyı boşaltabilecek ve tekrar kullanımına engel olmayacak sızdırmayan kapaklı veya yivli bir düzenek olmalıdır. Milimetre ölçekli olmalı. Borusu dolanmayı engellemelidir
6. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
7. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
8. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az dört yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
9. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
10. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
11. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
12. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
13. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.


13.DOĞUM SETİ



1. Tüm set bir karton kutu (Paket) içerisinde olacak. Tüm içerisindeki malzemelerin sterilitesi sağlanmış olacak. Tek kullanımlık olacak, Paket içerisinde en az:

- -1 adet çift Steril Muayene eldiveni bulunacak
- -1 adet dışbosable Plastik Önlük bulunacak
- -1 adet Plastik Hasta altı Peti.
- -1 adet disposable Hasta altı emici kağıt battaniyesi bulunacak
- -3 adet disposable orta boy havlu
- -4 adet steril gazlı bez -2 adet steril göbek klemp
- -1 adet disposable steril saplı bistüri takımı
- -1 adet şeffaf orta boy plastik Plasenta taşıma torbası ve bağlama materyali
- 1 adet steril doğum sonrası kullanımlık Ped
- -2 adet antiseptik özellikli el temizleme kağıdı
- -1 adet disposable steril bulb şırıngası (Yenidoğan aspirasyonu için)

2. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
3. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
4. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
5. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az beş yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
6. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
7. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
9. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen

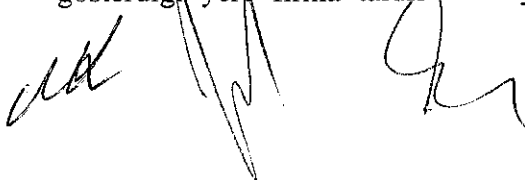

ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.


14.SAF ALKOL

1. En az %95 saf etil alkol olmalıdır.
2. Mühürlü, orijinal etiketli ve şeffaf plastik bidonlarda olmalıdır.
3. Renksiz, normal alkol kokulu, berrak olmalıdır.
4. 5 Litrelik orijinal bidonlarda olmalıdır.
5. Tıbbi amaçlı kullanılmalıdır.
6. 77 C – 77,5 C’de kaynamalıdır.
7. Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkolü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
8. Teklif verecek firmalar TAPDK’NİN kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır.
9. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
10. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
11. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
12. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
13. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az dört yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
14. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
15. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.

16. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

15.DISPOSABLE KÜVÖZ VENTİLATÖR DEVRESİ

1. İnhalasyon hava geçişini sağlayan 1 adet hortumdan ve valften oluşmalıdır.
2. İnhalasyon hortumunun ucunda yer alan adaptör sayesinde cihaza bağlantı yapılabilmelidir.
3. Hortum, ambulanslarımızdaki kuvöz MPV 10 serisi tüm ventilatörlerle uyumlu olmalıdır.
4. Maske ve endotrakeal tüpe takılmaya uygun olmalıdır.
5. Hortum bükülmelerde akımı engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Hortum hafif ve kokusuz olmalıdır
7. En az 2 yıl garantili olmalıdır
8. .Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
9. CE belgesi olmalıdır
10. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
11. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
12. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
13. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
14. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
15. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.

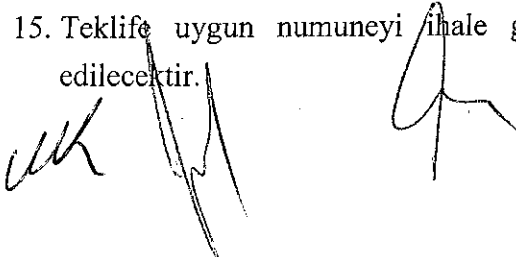

16. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.


16. SEYYAR PULSOKSİMETRE

1. Cihaz uzun süreli parmağa takılı kullanımda 2 yıl garantili olmalıdır.
2. Cihazın herhangi bir kablo bağlantısı olmamalıdır.
3. Cihaz üzerinde oksijen saturasyonu ve nabız göstergesi olmalıdır.
4. Cihaz kullanım sonunda otomatik kapanmalıdır.
5. Cihaz 2 adet ince alkalın pille çalışmalıdır.1.5V(AAA)x2
6. Reasuble probun üzerindeki saturasyon LCD2 digital-pulse LCD bar-graph olmalıdır.
7. Cihaz oksijen saturasyon ölçüm aralığı %50 ile %99 aralığında olmalıdır.
8. Cihazın bataryası boşalması durumunda LCD ekranında pil ikaz göstergesi olmalıdır.
9. Cihaz yetişkin hastalar için kullanıma uygun olmalıdır.
10. Cihazın boyun askılığı olmalıdır.
11. Cihaz kullanım kitapçığı olmalıdır.
12. Cihaz LCD ekranında kalp ritmini göstermelidir.
13. Cihaz fabrikasyon hatalara karşı yüklenici firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.
14. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
15. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
16. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
17. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
18. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
19. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.
20. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere

firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

17. VENTİLATÖR BAKTERİ FİTRESİ

1. Bakteri ve virüs filtresi olmalıdır.
2. Filtrasyon etkinliği en az virüs için %99.999, bakteri için %99.999 olmalıdır.
3. Steril ve disposable olmalıdır
4. Ölü boşluğu 90 ml den, pediatrik olanında ölü boşluk 35 ml den az olmalıdır.
5. Hafif olmalıdır. (≤ 40 g), pediatrik olanlar için (≤ 20 g) altında olmalıdır.
6. Anestezi cihazı veya invaziv, noninvaziv mekanik ventilatör standart solunum devresi veya endotrakeal tüp ajutajlarına uygun olmalıdır veya uygun hale getirmek için gerekli aparatları ile birlikte verilmelidir.
7. Filtrenin üzerinde kapnograf çıkışı olmalıdır. Hava akış rezistansı düşük olmalıdır. Teklif mektubu ekinde tüm özellikleri belgelenmelidir.
8. Tek tek paketlerde olmalıdır.
9. Filtre sırtı, oxivent ,meventi ve weinmann ventilatör devrelerine uyumlu olmalıdır.
10. Ürünün miadı depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 1(bir) ay kala firmaya bildirildiğinde birebir uzun miatlı ürün ile değişimi (15 gün içinde) sağlanacaktır.
11. Teklif edilen malzemelerin ve firmaların Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. UBB kaydı olmayanlardan taahhütname istenecektir ve malzemelerin en az ISO, CE ya da TSE belgelerden birine sahip olmaları gerekmektedir.
12. İhalede teklif edilecek bütün malzemeler için şartnamede belirtilen maddelere uygun olduğuna dair madde firma taahhüttün yer aldığı belge kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında yer alacaktır.
13. Teslim edilecek ürünlerin üzerindeki etikette ruhsat tarihi, numarası, imal tarihi, seri kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak ve hepsi aynı tarihli olacaktır. Ürünler karışık miatlı olmayacak lot numaraları aynı olacaktır.
14. Malzemenin teslimi sırasında ve üretiminden kaynaklanan sorunlardan, meydana gelecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
15. Muayene komisyonu gerek duyduğu sıhhi malzemeyi Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, burada incelenmediği takdirde bir kuruluşa kalite kontrolü için gönderebilecektir. Analiz ücreti kontrol için gönderilecek numune yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

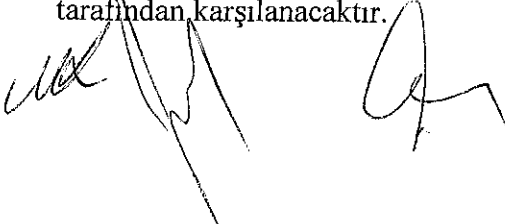

16. Teklife uygun numuneyi ihale günü yanlarında bulundurup idareye teslim edilecektir.

17. İhale sonrası malzemelerin teslimi için Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi (Ayniyat-Depo) tarafından randevu alınacak ve ürün geldiğinde deponun gösterdiği yere firma tarafından uygun şekilde istiflenecektir. kargo ile gelen ürünlerde teslim esnasında bir firma yetkilisi mutlaka malzemenin başında olacaktır, firma yetkilisi olmadan yapılan teslimattan kaynaklanan sorunlardan yüklenici sorumludur.

18.10.2016
Mustafa KARATAK
Mustafa

Zekeriya NIZ
Zekeriya NIZ

Savaş BAPAE
Savaş BAPAE